
essence® dental

A essência do sorriso



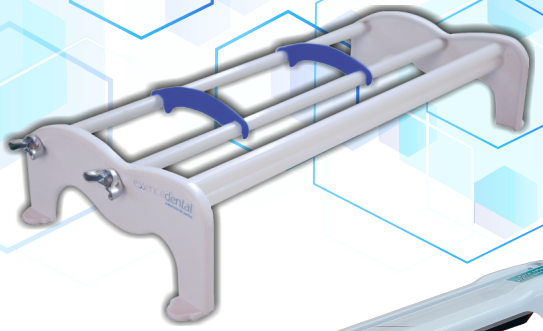

Manual de Instruções

Selamaxx com Suporte Rolo

Aviso legal:

As informações contidas neste manual são protegidas por leis de direitos autorais e são de propriedade da ESSENCE DENTAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, ficando ao seu critério fazer alterações às especificações e atributos sem aviso prévio.

Nenhuma parte deste manual pode ser reproduzida, copiada, traduzida ou publicada de qualquer forma ou através de quaisquer meios sem permissão prévia por escrito da ESSENCE DENTAL.

Agradecimento:

Parabéns, você acaba de adquirir SELAMAXX da ESSENCE DENTAL.

Este equipamento foi submetido a um rigoroso controle de qualidade e segurança, a fim de oferecer o que há de melhor no mercado em relação á tecnologia, funcionalidade e design, sempre atendendo os requisitos da vigilância sanitária.

Atenção:

É imprescindível que sejam lidas todas as informações contidas neste manual, para tirar o maior proveito possível de todos os recursos que este equipamento oferece, evitando o uso inadequado, possíveis acidentes e danos ao equipamento. Após leitura e entendimento, guarde o manual, juntamente com a nota fiscal de compra e o certificado de garantia em local seguro.


Aplicação:


A Seladora é utilizada para selar embalagens confeccionadas em papel grau cirúrgico ou plástico. Podem ser utilizadas em consultórios odontológicos e médicos, laboratórios, clínicas, hospitais, etc.

Características e benefícios:

• 30 cm de área livre para selagem;
• Bivolt automática, portanto não necessita mudar de chave seletora de voltagem;
• Fita de proteção térmica (conhecida como fita armalon) avulsa que isola a resistência para que não fique diretamente em contato com o saco plástico de esterilização – não é necessário para o uso no papel cirúrgico;
• Leve, compacta e ergonômica;
• Qualidade e eficiência no processo de selagem de materiais por possuir 10 mm de espessura;
• Guilhotina para corte (ambos os lados);
• 12 meses de garantia para defeitos de fabricação;
• Baixo custo para peças de reposição.

Componentes:

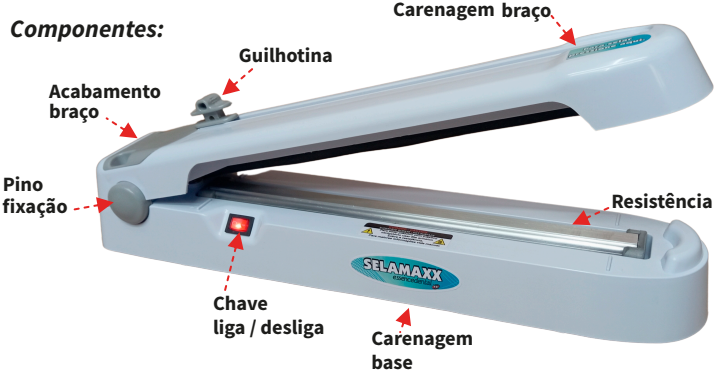

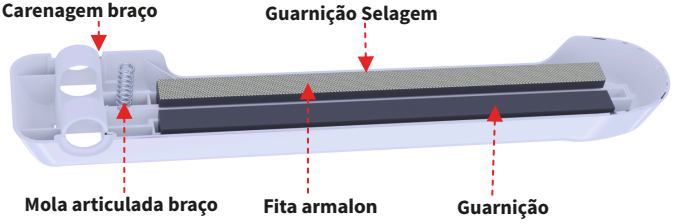

Instalação e uso inicial:

A SELAMAXX é bivolt automática, portanto não necessita de regulagem de voltagem.
Instale a sua SELAMAXX em uma base plana e ventilada a uma distância mínima de 40 cm de fontes de calor e umidade.
Conecte o cabo de alimentação da SELAMAXX na tomada da rede elétrica.

Funcionamento:

Selagem de plástico com plástico:
1º Passo - Cole a fita armalon extra que acompanha o produto na resistência;
2º Passo - Acione a chave liga/desliga para ligar o equipamento;
3º Passo - Aguarde aproximadamente 15 minutos para que a seladora atinja a temperatura ideal de selagem (a temperatura da seladora é fixa e controlada automaticamente);
4º Passo - Coloque o plástico sobre a resistência e pressione o braço da seladora firmemente por aproximadamente 4 segundos.

Selagem de papel grau cirúrgico:
1º Passo - Acione a chave liga/desliga para ligar o equipamento;
2º Passo - Aguarde aproximadamente 8 minutos para que a seladora atinja a temperatura ideal de selagem (a temperatura da seladora é fixa e controlada automaticamente);
Caso esteja com a fita armalon sobre a resistência, o tempo de aquecimento passará de 08 para 15 minutos.
3º Passo - Coloque o envelope papel grau cirúrgico sobre a resistência (com a face do papel cirúrgico voltado para a resistência e o filme plástico voltado para cima) e pressione o braço da seladora firmemente por aproximadamente 4 segundos.
Obs.: Para o uso nos dois tipos de selagem (plástico e papel cirúrgico) seguir o processo da selagem de plástico com plástico. Não é necessária a remoção da fita armalon quando esta já foi colada na resistência para uso de plástico.

Cuidados
• Ao manusear o papel ou após desligá-la, cuidado para não colocar o dedo na resistência, pois há risco de queimadura;
• Cuidado ao manusear o papel ou plástico para não se cortar com as lâminas.

Conselhos:

• Manter o equipamento longe de inflamáveis;
• Manter o equipamento, ao menos, a 40 cm de fontes de calor;
• Manter o equipamento longe do alcance dos raios solares diretos;
• Desligue-o na chave e da rede elétrica quando não estiver em uso;
• Não insira nenhum objeto em qualquer abertura do aparelho;
• Não tente transportar o equipamento sustentando-o pelo cabo de força;
• Para desplugar da tomada, puxe pelo plugue e nunca pelo cabo;
• Nunca deixe o cabo encostar-se a superfícies quentes;
• Manter o equipamento fora do alcance de crianças ou pessoas sem habilidade para o manuseio adequado.

Manutenção e limpeza:

• Desligue o equipamento na chave e também da tomada para realizar qualquer manutenção ou limpeza;
• Para realização da limpeza da carenagem, utilize um pano úmido com detergente líquido neutro ou álcool;
• Nunca submergir o aparelho em água ou qualquer líquido, nem o coloque debaixo da torneira.


Troca da lâmina :
As lâminas utilizadas na substituição serão as de bisturi número 12.



Retire a tampa superior do braço da SELAMAXX (Cuidado ao remover para não quebrar as travas).




Puxe a guilhotina até o canal posicionado sob a tampa superior para retirá-la.





Com um leve toque, desconecte as duas partes da guilhotina, fazendo com que a mola perca sua ação (muito cuidado nesta operação, pois a mola pode se perder).





Retire o parafuso que prende as lâminas, em seguida com uma chave de fenda empurre as lâminas até se desencaixarem da trava.







Posicione a nova lâmina de modo que a mesma fique centralizada no canal e na trava de segurança. Feito isso, basta apenas empurrá-la para cima, até que fique totalmente encaixada. Faça este processo nas duas lâminas, lembrando que uma deve ficar voltada com o corte para o lado contrário da outra.
Depois de encaixadas as duas lâminas, recoloque o parafuso de fixação e monte novamente a guilhotina, colocando a mola entre as partes e recolocando o conjunto novamente na máquina.

A garantia da ESSENCE DENTAL NÃO TERÁ VALIDADE caso:

• Os documentos estejam adulterados, alterados ou ilegíveis de alguma forma.
• O número de série no equipamento for alterado, apagado, removido ou tornado ilegível.
• Defeitos ou danos recorrentes de reparos, desmonte, testes, instalação, alteração ou qualquer tipo de modificação realizada por pessoas ou assistências técnicas não autorizadas pela ESSENCE DENTAL.
• Na instalação do equipamento não forem observados as especificações e recomendações quanto às condições descritas neste manual, tais como, nivelamento do equipamento, adequação do local para instalação, tensão elétrica, condições hidráulicas e pneumáticas compatíveis.
• Defeitos ou danos causados por queda, acidentes, uso indevido, negligência, descarga na rede elétrica, relâmpago, água ou fogo.
• Arranhões, fissuras, trincas ou qualquer outro dano causado ao equipamento, em razão do uso diverso ao especificado no manual.


Itens Excludentes de garantia:
• Qualquer acessório ou componente sujeito a desgaste natural durante o uso do equipamento, tais como: iluminação, refil de jateadores, filtro do exaustor, luvas, eletrodos, fita armalon, disco de corte, chaves elétricas em geral, fusíveis, lamina de corte, entre outros que não caracterizam defeito de fabricação, independente do prazo de garantia.


Assistência Técnica:
Para evitar qualquer inconveniência desnecessária, por favor, leia atentamente todas as instruções que se encontram neste manual, antes de entrar em contato.

Caso o seu equipamento ESSENCE DENTAL não esteja funcionando corretamente ou tenha alguma duvida, critica ou sugestão entre em contato com o SAC (Serviço de Atendimento ao Consumidor), estando em posse deste manual, certificado de garantia e NF/Recibo de compra através do:
E-mail: sac@essencedental.com.br (preferencialmente).
Telefone: (16) 3334-2000 Ramal 301 ou 302.

Suporte Rolo

essence® dental
A essência do sorriso

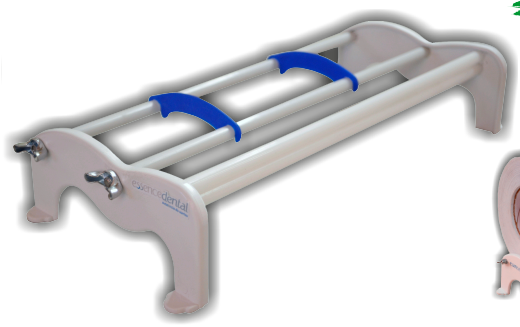




Aplicação

Para apoiar rolo de papel grau cirúrgico até 300 mm.
Características e benefícios
- Capacidade para mais de um rolo;
- Acompanha separador de rolos;
- Leve e compacta;
- Fácil de montar;
- Baixo custo para peças de reposição

Componentes:

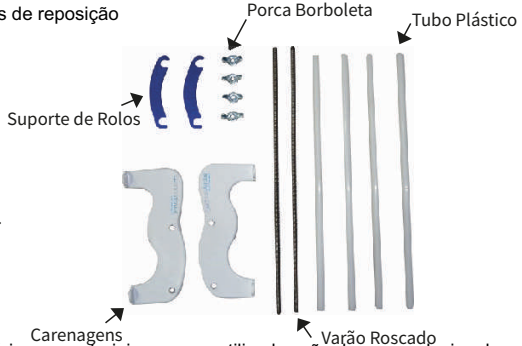

Fotos meramente ilustrativas.

Todas as partes, acessórios ou materiais a serem utilizados são de uso exclusivo do produto, o uso de qualquer parte, acessório ou material não especificado é de inteira responsabilidade do usuário.

Instalação e uso inicial

1° passo: Encaixe o varão roscado dentro do tubo plásticos, deixando uma
ponta para cada lado. Faça esse processo com os dois varão.




2° passo: Encaixe um dos tubos com o varão no furo central de uma das
carenagens, e pelo outro lado rosqueie com porca borboleta, sem apertar
somente para segurar (aproximadamente 3 voltas).



3° passo: Repita o processo anterior no furo traseiro da carenagem, ou seja, o lado oposto do logo “Essence Dental”.



4° passo: Encaixe os dois tubos sem varão nos pinos de encaixe que fica na parte da frente da carenagem.



5° passo: Em seguida encaixe todos os tubos e varão na outra carenagem e rosqueie pelo lado de fora as porcas borboleta até travar.



6° passo: Coloque o rolo sobre os tubos com varão e passe o papel entre os tubos sem varão



Obs.: Se for usar mais de um rolo ou um único rolo inferior á 300 mm encaixar separador entre os rolos e nos tubos na parte traseira onde vai apoiado o rolo e que tem varão internamente.
Posicione o seu suporte de rolo preferencialmente próximo a sua seladora, em uma base plana, nivelada, lisa (de modo que o equipamento fique estável para trabalhar),temperatura ambiente, ventilada, em altura adequada para o manuseio, a uma distância mínima de 40cm de fontes de calor e umidade.

Conselhos:

- Manter o equipamento longe de inflamáveis.
- Manter o equipamento ao menos 40 cm de fontes de calor.
- Manter o equipamento longe do alcance dos raios solares diretos.

Manutenção e limpeza:
- Para realização da limpeza da carenagem utilize um pano úmido com detergente líquido neutro ou álcool.

Diagnósticos de falhas:

Falha apresentada	Causa provável	Solução
Tubos frouxos	Porca Borboleta	Falta de aperto da porca borboleta.
	Desalinhada em relação ao pino	Verifique se o tubo está encaixado corretamente nos pinos.

Termos de garantia:
Caso este equipamento apresente algum defeito de fabricação, a ESSENCE DENTAL cobre os custos de mão de obra e reposição das peças, durante o prazo de doze (12) meses. Sendo os três (3) primeiros meses de garantia legal e os nove (9) últimos meses garantia especial concedida pela ESSENCE DENTAL, a partir da data de compra.
Caso seja realizada a substituição do equipamento ou peça durante a garantia,o prazo não será estendido, ou seja, a data inicial valida continua sendo a informada na nota fiscal de compra.
A garantia da ESSENCE DENTAL será valida desde que o equipamento seja utilizado corretamente (ao uso que se destina), conforme as instruções contidas neste manual e sob a apresentação da nota ou cupom fiscal de compra, indicando a data e o nome do revendedor, juntamente com o certificado de garantia devidamente preenchido.
Despesas com deslocamento (envio e retorno) do equipamento, independente da maneira a ser enviada: por correio, presencial ou transportadora, bem como os riscos e seguro do envio é de responsabilidade do usuário.

A garantia da ESSENCE DENTAL NÃO TERÁ VALIDADE caso:
• Os documentos estejam adulterados, alterados ou ilegíveis de alguma forma.
• O número de série no equipamento for alterado, apagado, removido ou tornado ilegível.
• Defeitos ou danos recorrentes de reparos, desmonte, testes, instalação, alteração ou qualquer tipo de modificação realizada por pessoas ou assistências técnicas não autorizadas pela ESSENCE DENTAL.
• Na instalação do equipamento não forem observados as especificações e recomendações quanto às condições descritas neste manual, tais como, nivelamento do equipamento, adequação do local para instalação, tensão elétrica, condições hidráulicas e pneumáticas compatíveis.
• Defeitos ou danos causados por queda, acidentes, uso indevido, negligência, descarga na rede elétrica, relâmpago, água ou fogo.

Assistência Técnica:
Para evitar qualquer inconveniência desnecessária, por favor, leia atentamente todas as instruções que se encontram neste manual, antes de entrar em contato.

Caso o seu equipamento ESSENCE DENTAL não esteja funcionando corretamente ou tenha alguma dúvida, crítica ou sugestão entre em contato com o SAC (Serviço de Atendimento ao Consumidor), estando em posse deste manual, certificado de garantia e NF/Recibo de compra através do:
E-mail: sac@essencedental.com.br (preferencialmente).
Telefone: (16) 3334-2000 Ramal 301 ou 302.

Itens Excludentes de garantia:
• Qualquer acessório ou componente sujeito a desgaste natural durante o uso do equipamento, tais como: iluminação, refil de jateadores, filtro do exaustor, luvas, eletrodos, fita armalon, disco de corte, chaves elétricas em geral, fusíveis, lamina de corte, entre outros que não caracterizam defeito de fabricação,independente do prazo de garantia.

Características Técnicas:
Modelo: Suporte Rolo Papel Grau Cirurgico
Peso líquido: 0,280 Kg
Peso bruto: 0,380 Kg
Dimensões: 360mm (comprimento), 75mm (altura) e 170mm (largura).